

RAPPORT D'ÉTALONNAGE #30203-1

RPM TRANSIT

284, CHEMIN KEENAN
MELBOURNE, QC
JOB 2B0



Balances et solutions de pesage

2415, rue du Power
Drummondville, Québec J2C 6Z5
819-471-5077

545, rue du parc Industriel
Sherbrooke, Québec J1C 0J2
819-846-2226

ÉQUIPEMENT

Description: **balance axial**

Indicateur	Base	Imprimante
Marque: RICE LAKE	Marque: SOUDURE DENIS R	Marque:
Modèle: 682-2A	Modèle: N/A	Modèle:
No. Série: 2020400088	No. Série: N/A	No. Série:



#Outil: **N/A** Capacité: **50000 kg** Graduation **10 kg**

INSPECTION VISUELLE

Inspection visuelle conforme Commentaires:

EXCENTRATION (2 SECTIONS)


Poids appliqué:

10000


Tolérance:

20

Unité de mesure:
Kilogramme (kg)

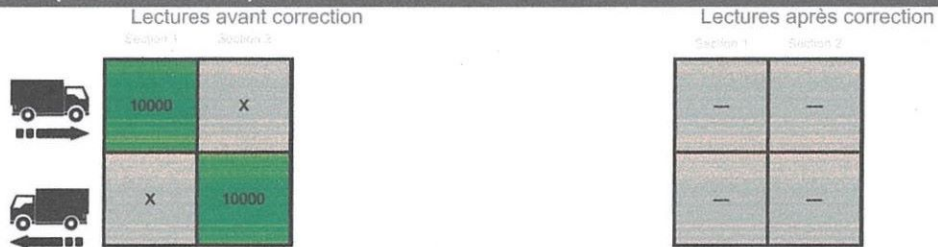

LINÉARITÉ

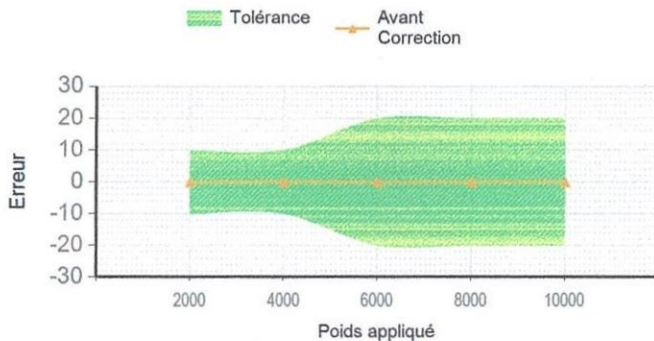

Lecture #	Poids appliqué	Tolérance permise	Charge	Avant correction	Après correction
1	2000	±10	0	2000	--
2	4000	±10	0	4000	--
3	6000	±20	0	6000	--
4	8000	±20	0	8000	--
5	10000	±20	0	10000	--

Unité de mesure: **Kilogramme (kg)**

Poids étalons utilisés: **XCL01-XCL20**
XCL01-XCL20
XCL01-XCL20



Certificats

RÉSULTAT:

CONFORME

Technicien:

Pascal Pinard

Signature:



Date d'étalonnage: **2024-07-20**
Date due: **2025-06**